



ETA SCAN MESSUNG - AQUA POWER JOINT

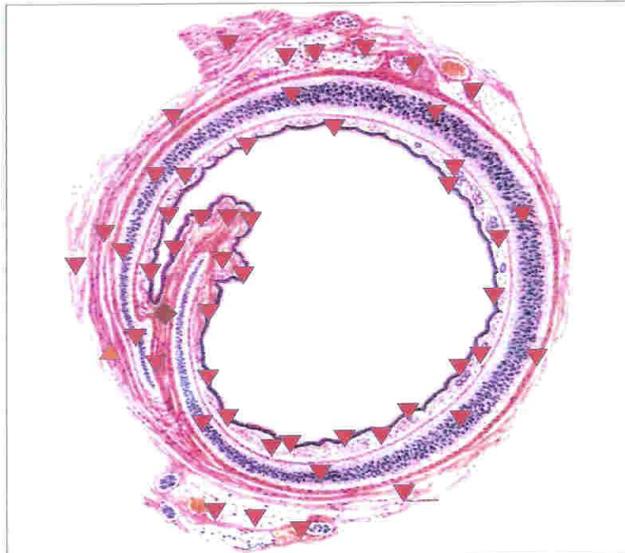

13.07.2006 Bronchus, Querschnitt

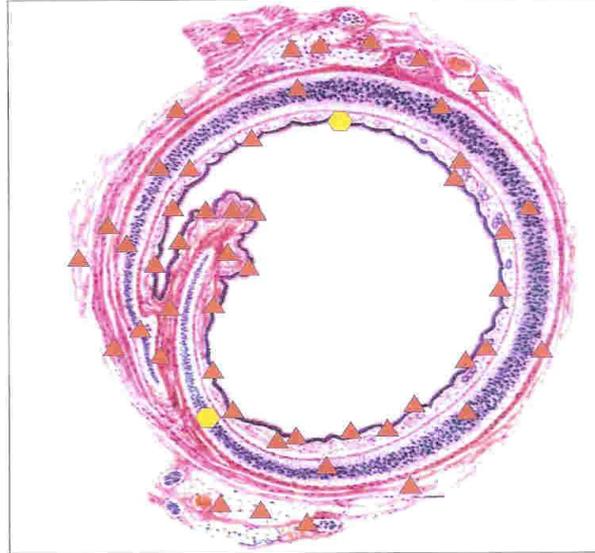

13.07.2006 Bronchus, Querschnitt

APJ

Diagnose:

Die Messung der Bronchien im Querschnitt zeigt eine Belastung von 0,794 Toxoplasma Gondii – Heel. Der Erreger ist ein intrazellulärer Parasit, der von der Hauskatze auf den Menschen übertragen wird.

Therapie:

Die Eigenfrequenz von Aquapower-belebtem Wasser wurde mittels dem ETAScanner auf das belastete Organ aufgeschwungen und ergab eine energetische Verbesserung um erstaunliche 59% !

Schlussfolgerung:

Mit dem ETAScan Energie-Balance-System lässt sich die positive Wirkung des Aquapower-belebten Wassers auf den Organismus wirkungsvoll darstellen.

Admin: Admin _____



Latente dynamische Aktivität



Keine besonderen Abweichungen von der Norm



Kompensatorische Probleme der Anpassungsmechanismen




Optimale Regulierung




Allgemeine Schwächen des regulierenden Mechanismus



Starke energetische Probleme des Anpassungsmechanismus; pathologischer Zustand

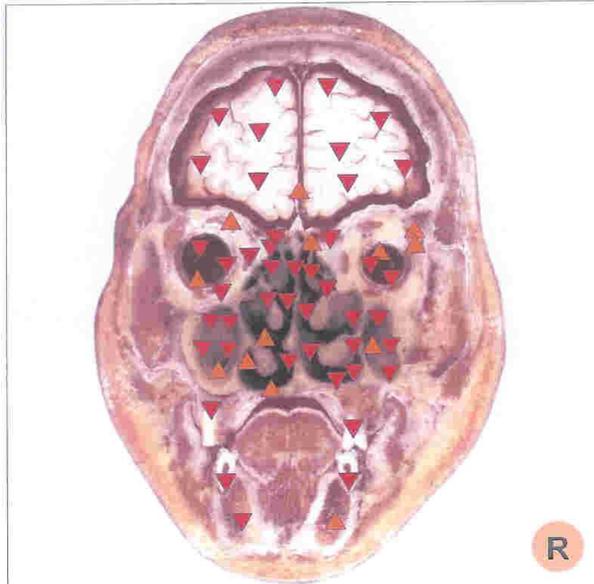

13.07.2006 Kopf, Coronarschnitt

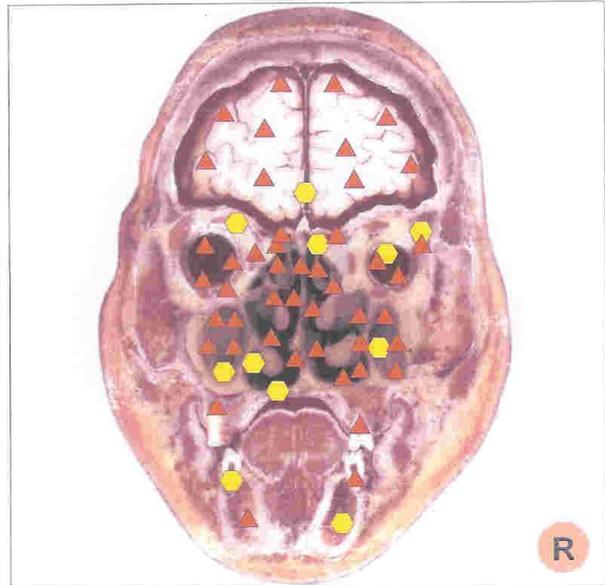

13.07.2006 Kopf, Coronarschnitt

APJ

Auch bei der vorliegenden Messung > Kopf-Coronarschnitt wurde als Therapie **Aquapower** – belebtes Wasser mittels ETAScan eingeschwungen und ergab eine energetische **Verbesserung** in diesem Bereich um **58%** .

Admin: Admin _____

